# Purification of C60 Buckminsterfullerene



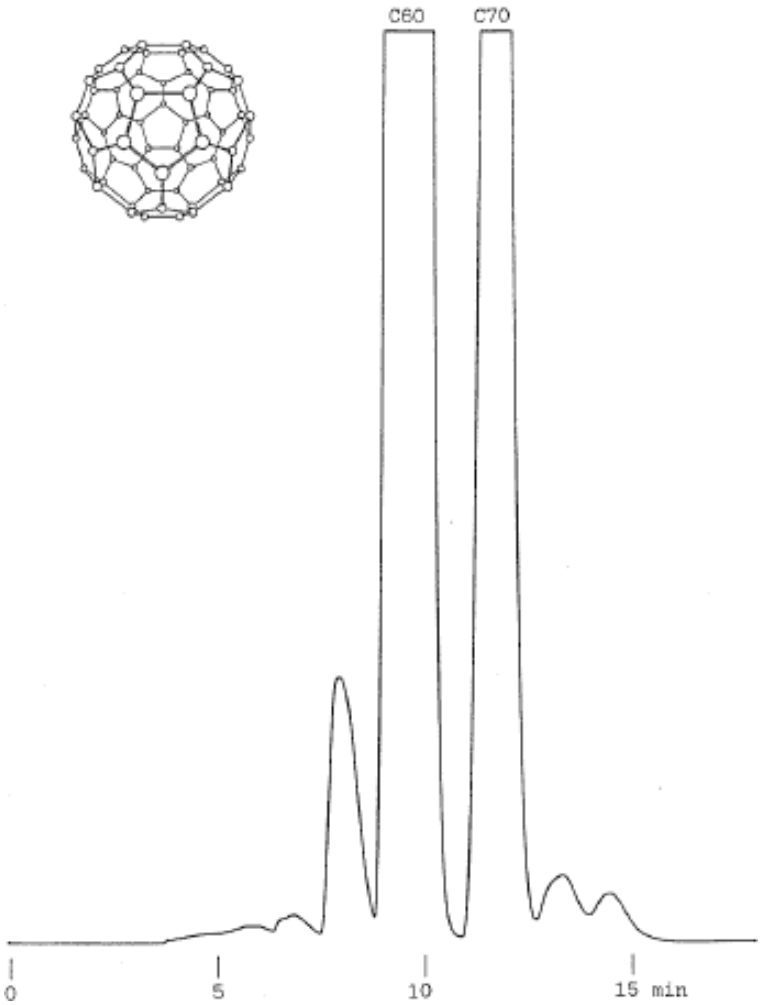


| | | | |
|---|---|---|---|
| Column | : Inertsil PREP-ODS<br>10µm<br>250 × 30 mm I.D. | Solutes | : 1. C60 (0.01 % in Eluent)<br>2. C70 (0.01 % in Eluent) |
| Column Cat. No. | : 5020-31133 | | |
| Eluent | : Toluene/$CH_3CN$ = 60/40 | | |
| Flow rate | : 25 mL/min. | | |
| Col. Temp. | : 40ºC | | |
| Detection | : UV 350 nm | | |
| Injection Vol. | : 25 mL | | |
| Sample | : Crude C60, C70 | | |