
Analysis of α-Lipoic acid

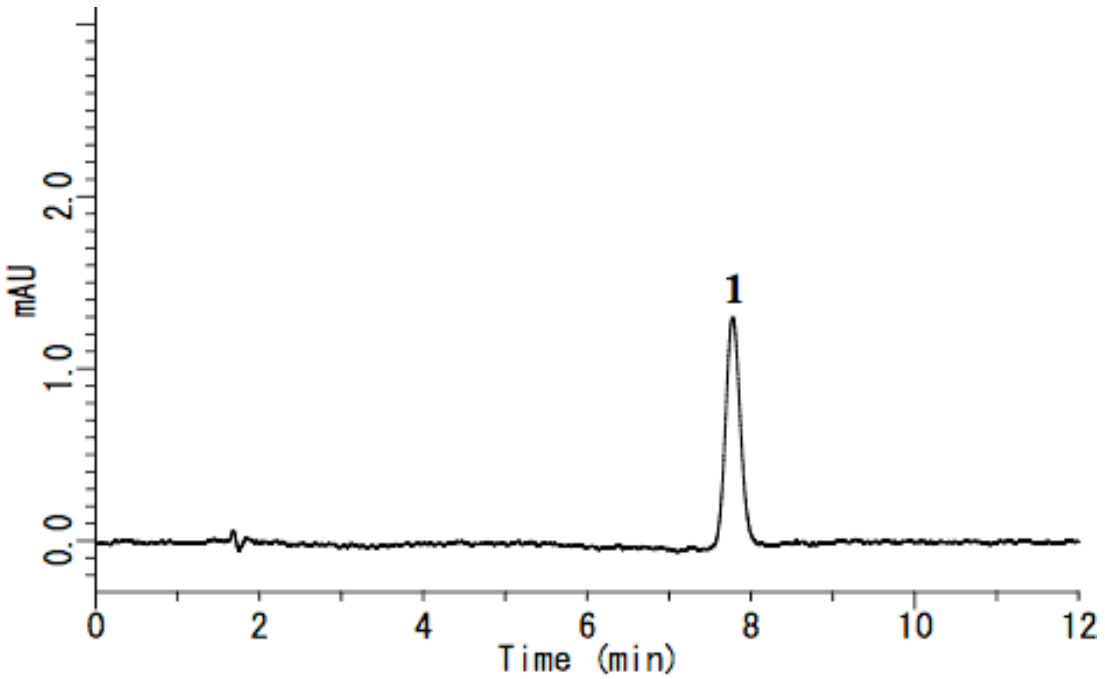

System : GL-7400 system

Column : Inertsil ODS-3 (4 µm, 150 x 4.6 mm I.D.)

Column Cat. No. :

Eluent : A)CH_3OH
B) 20 mM NaH2PO4 (pH 2.5; H_3PO_4)
A/B = 60/40 ,v/v

Flow rate : 1.0 mL/min

Col. Temp. : 40 °C

Detection : UV 333 nm (GL-7450 UV Detector)

Injection Vol. : 20 µL

Sample :

Solutes : 1. α-Lipoic acid (1.0 mg/L)